


## CJD早期診断における拡散強調画像ADC値の機種間差異

研究分担者：岩手医科大学 佐々木真理

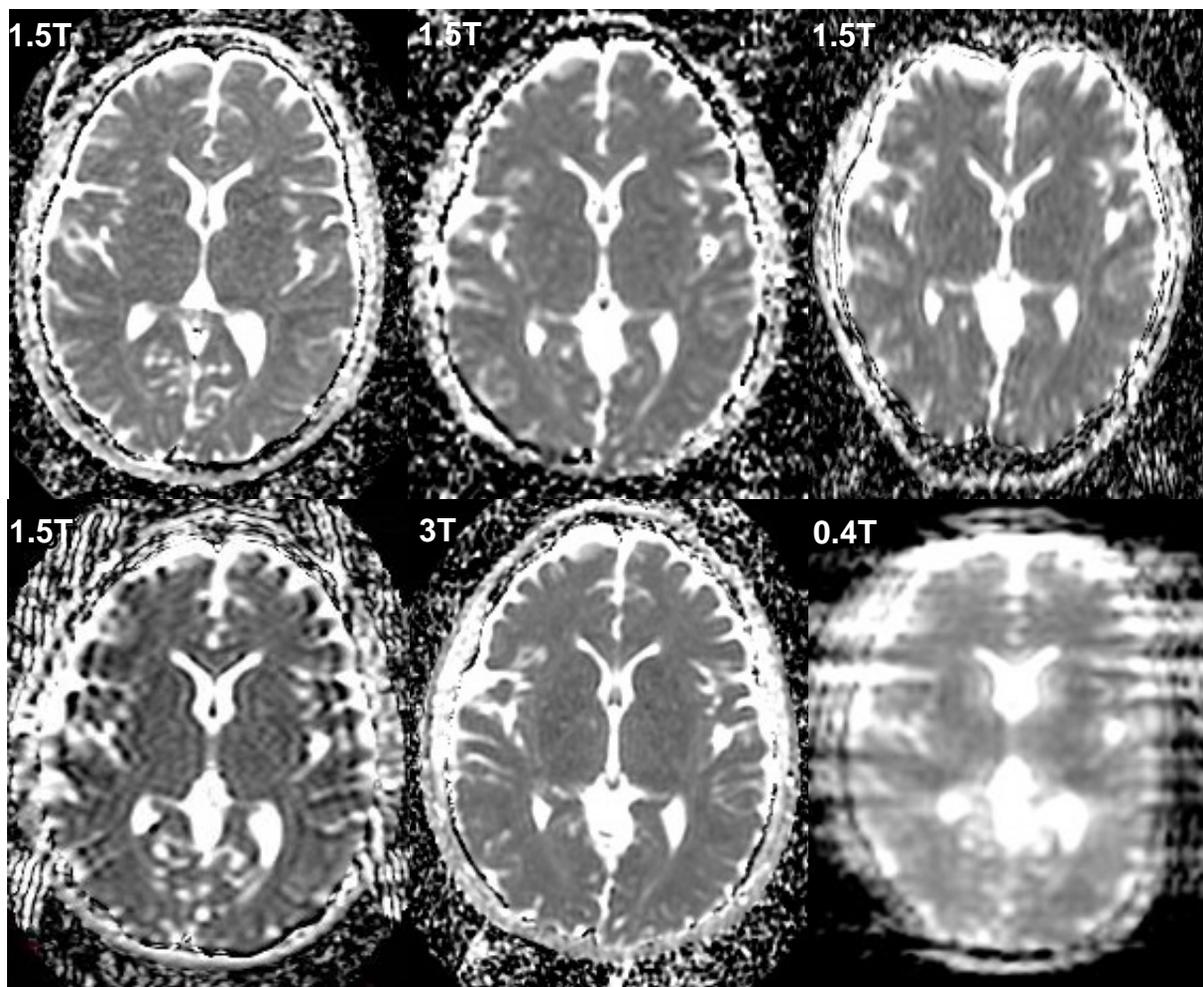

### 解説

1. ボランティア12名を5企業14機種のMRIで撮像した(1.5Tx10, 3Tx2, 0.4Tx2)。
2. 1.5Tでは一部の装置でADC値が大きく異なっていた(左下)。
3. 1.5Tと3Tの間にはADC値に大きな差異はなかったが、0.4Tでは著しく異なっていた(右下)。